
Das 10 mm Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist in einem sterilen Behältnis mit Tyvek-Hülle verpackt.

- Entnehmen Sie den Behälter **VOR** dem Einsatz in einer sterilen Umgebung aus der Schachtel.
- Die Tyvek-Abdeckung zurückziehen, um das sterile Instrument zu entnehmen.
- Der Nadelverriegelungs-Schiebeknopf befindet sich nahe der Griff-Fingerschlaufe.



Anmerkung: Elektroden mit Kochsalzlösung befeuchten, um das Einführen durch die Nadelspitze zu erleichtern.

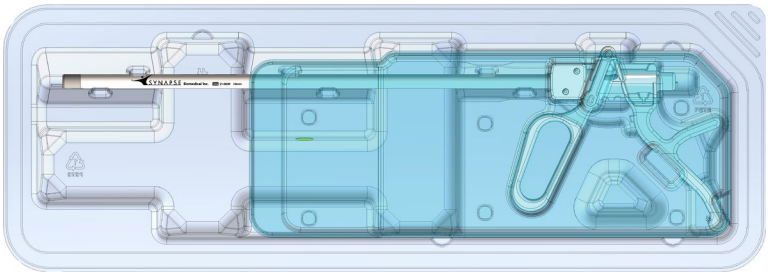

- Option #1: Einlegen der Elektrode mit Nadel im Winkel von 180°:
  - Drücken Sie den Griff in die zweite Verriegelungsposition und verriegeln Sie die Nadel durch Drücken des Schiebeknopfes.
  - Legen Sie das Silberstiftende der Elektrode in den Bereich der Abschrägung der Nadelspitze.
  - Halten Sie die Elektrode parallel zur Nadel, um die Silikonummantelung der Elektrode beim Einlegen durch die Kanüle des Instruments nicht zu beschädigen.
  - Die Elektrode NICHT durch Kraftausübung beim Schieben durch die Nadelschräge beschädigen.
  - Die Elektrode weiter durch die Nadel schieben, bis sich die Elektrodenspitze der Abschrägung der Nadel nähert.
  - Legen Sie den Daumen gegen die Abschrägung der Nadelspitze und ziehen Sie die verbleibende Elektrode durch die Kanüle des Instruments. Stellen Sie sicher, dass die blaue Spitze vollständig in der Abschrägung der Nadel liegt.
  - Vergewissern Sie sich, dass nur die Elektroden-Stimulationsspitze der Elektrode aus der Nadelspitze des Elektrodeneinführungsinstruments austritt.
  - Halten Sie den Griff und entriegeln Sie die Nadelposition durch Drücken des Schiebereglers.



- Option #2: Einlegen der Elektrode mit Nadel im Winkel von 90°:
  - Drücken Sie den Griff in die erste Verriegelungsposition und verriegeln Sie die Nadel durch Drücken des Schiebeknopfes.
  - Legen Sie das Silberstiftende der Elektrode in den Bereich der Abschrägung der Nadelspitze (1)
  - Halten Sie die Elektrode parallel zur Nadel, um die Silikonummantelung der Elektrode nicht zu beschädigen.
  - Die Elektrode NICHT durch Kraftausübung beim Schieben durch die Nadelschräge beschädigen.
  - Schieben Sie die Elektrode durch die Nadel, bis sich die Elektrodenspitze der abgeschrägten Spitze nähert.
  - Das silberne Stiftende der Elektrode in die Öffnung der Elektrodenkanüle einführen (2)
  - Schieben Sie die Elektrode weiter durch die Elektrodenkanüle, bis sie auf der anderen Seite des Instruments herauskommt.
  - Legen Sie den Daumen gegen die Abschrägung der Nadelspitze und ziehen Sie die verbleibende Elektrode durch die Kanüle des Instruments. Stellen Sie sicher, dass die blaue Spitze vollständig in der Abschrägung der Nadel liegt.
  - Vergewissern Sie sich, dass nur die Elektroden-Stimulationsspitze der Elektrode aus der Nadelspitze des Elektrodeneinführungsinstruments austritt.
  - Entriegeln Sie die Nadelposition, indem Sie den Schiebeknopf drücken.
- AUSSCHLIESSLICH zum einmaligen Gebrauch. NICHT erneut sterilisieren.

Entsorgung des Elektrodeneinführungsinstruments

- Entsorgung von Verpackungsmaterial - Entsorgung fester Abfälle laut Krankenhausrichtlinien
- Alle Teile mit potenziell biologisch gefährlicher Kontamination - In einem entsprechend großen Behälter für biologisch gefährliche, bzw. scharfe/spitze Gegenstände entsorgen.
- Bitte befolgen Sie die Richtlinien des Krankenhauses für die ordnungsgemäße Entsorgung.

300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tel: 1-888-767-3770 ext. 137
1-440-774-2488 ext. 137
Fax: 1-440-774-2572


Synapse Biomedical - Europa
7 Rue de la Liberation
95880 Enghien Les Bains, Frankreich
Frankreich +33 (0) 9 60 12 44 98
Andere europäische Länder
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797

REF 77-0086-1-DE
Rev. C

Das 10 mm Einweg-Elektrodeneinführungsinstrument ist in einem sterilen Behältnis mit Tyvek-Hülle verpackt.

- Entnehmen Sie den Behälter **VOR** dem Einsatz in einer sterilen Umgebung aus der Schachtel.
- Die Tyvek-Abdeckung zurückziehen, um das sterile Instrument zu entnehmen.
- Der Nadelverriegelungs-Schiebeknopf befindet sich nahe der Griff-Fingerschlaufe.

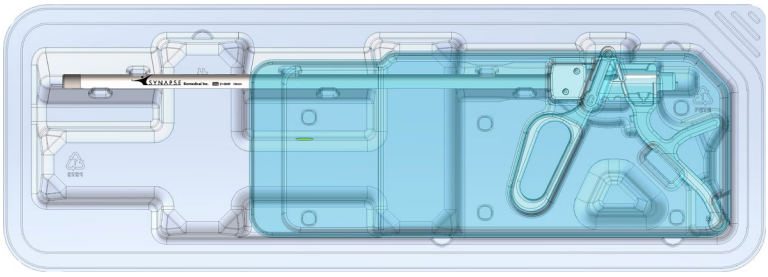

Anmerkung: Elektroden mit Kochsalzlösung befeuchten, um das Einführen durch die Nadelspitze zu erleichtern.



- Option #1: Einlegen der Elektrode mit Nadel im Winkel von 180°:
  - Drücken Sie den Griff in die zweite Verriegelungsposition und verriegeln Sie die Nadel durch Drücken des Schiebeknopfes.
  - Legen Sie das Silberstiftende der Elektrode in den Bereich der Abschrägung der Nadelspitze.
  - Halten Sie die Elektrode parallel zur Nadel, um die Silikonummantelung der Elektrode beim Einlegen durch die Kanüle des Instruments nicht zu beschädigen.
  - Die Elektrode NICHT durch Kraftausübung beim Schieben durch die Nadelschräge beschädigen.
  - Die Elektrode weiter durch die Nadel schieben, bis sich die Elektrodenspitze der Abschrägung der Nadel nähert.
  - Legen Sie den Daumen gegen die Abschrägung der Nadelspitze und ziehen Sie die verbleibende Elektrode durch die Kanüle des Instruments. Stellen Sie sicher, dass die blaue Spitze vollständig in der Abschrägung der Nadel liegt.
  - Vergewissern Sie sich, dass nur die Elektroden-Stimulationsspitze der Elektrode aus der Nadelspitze des Elektrodeneinführungsinstruments austritt.
  - Halten Sie den Griff und entriegeln Sie die Nadelposition durch Drücken des Schiebereglers.



- Option #2: Einlegen der Elektrode mit Nadel im Winkel von 90°:
  - Drücken Sie den Griff in die erste Verriegelungsposition und verriegeln Sie die Nadel durch Drücken des Schiebeknopfes.
  - Legen Sie das Silberstiftende der Elektrode in den Bereich der Abschrägung der Nadelspitze (1)
  - Halten Sie die Elektrode parallel zur Nadel, um die Silikonummantelung der Elektrode nicht zu beschädigen.
  - Die Elektrode NICHT durch Kraftausübung beim Schieben durch die Nadelschräge beschädigen.
  - Schieben Sie die Elektrode durch die Nadel, bis sich die Elektrodenspitze der abgeschrägten Spitze nähert.
  - Das silberne Stiftende der Elektrode in die Öffnung der Elektrodenkanüle einführen (2)
  - Schieben Sie die Elektrode weiter durch die Elektrodenkanüle, bis sie auf der anderen Seite des Instruments herauskommt.
  - Legen Sie den Daumen gegen die Abschrägung der Nadelspitze und ziehen Sie die verbleibende Elektrode durch die Kanüle des Instruments. Stellen Sie sicher, dass die blaue Spitze vollständig in der Abschrägung der Nadel liegt.
  - Vergewissern Sie sich, dass nur die Elektroden-Stimulationsspitze der Elektrode aus der Nadelspitze des Elektrodeneinführungsinstruments austritt.
  - Entriegeln Sie die Nadelposition, indem Sie den Schiebeknopf drücken.
- AUSSCHLIESSLICH zum einmaligen Gebrauch. NICHT erneut sterilisieren.

Entsorgung des Elektrodeneinführungsinstruments

- Entsorgung von Verpackungsmaterial - Entsorgung fester Abfälle laut Krankenhausrichtlinien
- Alle Teile mit potenziell biologisch gefährlicher Kontamination - In einem entsprechend großen Behälter für biologisch gefährliche, bzw. scharfe/spitze Gegenstände entsorgen.
- Bitte befolgen Sie die Richtlinien des Krankenhauses für die ordnungsgemäße Entsorgung.

300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tel: 1-888-767-3770 ext. 137
1-440-774-2488 ext. 137
Fax: 1-440-774-2572

Synapse Biomedical - Europa
7 Rue de la Liberation
95880 Enghien Les Bains, Frankreich
Frankreich +33 (0) 9 60 12 44 98
Andere europäische Länder
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797

REF 77-0086-1-DE
Rev. C