
La herramienta desechable de administración de electrodos de 10 mm se empaqueta en una bandeja estéril con cubierta Tyvek.

- Retire la bandeja de la caja **ANTES** de usarla en un entorno estéril.
- Tire hacia atrás de la cubierta de Tyvek para retirar la herramienta estéril.
- Localice el botón deslizante de bloqueo de la aguja cerca de la parte superior del lazo del mango para el dedo.



Nota: Humedezca los electrodos con solución salina para ayudar a la inserción a través de la punta de la aguja.

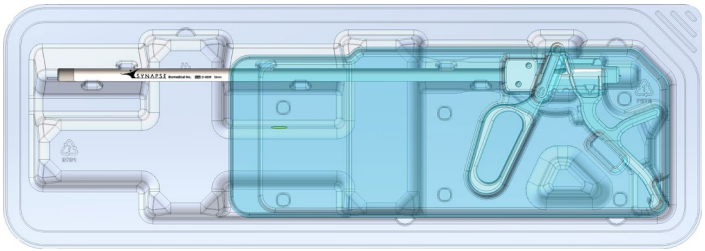

- Opción N.° 1: Carga del electrodo con aguja a 180°:
  - Apriete el mango hasta la segunda posición de bloqueo y bloquee la posición de la aguja empujando el botón deslizante.
  - Disponga el extremo del pasador plateado del electrodo en el área del bisel de la punta de la aguja.
  - Mantenga el electrodo paralelo a la aguja para no dañar la funda de silicona del electrodo mientras se carga a través del tubo de la herramienta.
  - NO dañe el electrodo forzando la entrada del bisel de la aguja.
  - Continúe empujando el electrodo a través de la aguja hasta que su punta se acerque al bisel de la aguja.
  - Coloque el pulgar contra el bisel de la punta de la aguja y tire del electrodo restante a través del tubo de la herramienta. Asegúrese de que la punta azul esté completamente dentro del bisel de la aguja.
  - Verifique que sólo la punta estimulante del electrodo esté saliendo de la punta de la punta de la aguja de la herramienta de administración de electrodos.
  - Sosteniendo el mango, desbloquee la posición de la aguja empujando el botón deslizante.



- Opción N.° 2: Carga del electrodo con aguja a 90°:
  - Apriete el mango hasta la primera posición de bloqueo y bloquee la aguja empujando el botón deslizante.
  - Coloque el extremo del pasador plateado del electrodo en el área del bisel de la punta de la aguja (1)
  - Conserve el electrodo paralelo a la aguja para no dañar la funda de silicona del electrodo.
  - NO dañe el electrodo forzando la entrada del bisel de la aguja.
  - Empuje el electrodo a través de la aguja hasta que la punta del electrodo esté cerca de la punta del bisel.
  - Inserte el extremo del pasador plateado del electrodo en la abertura del tubo del electrodo (2)
  - Continúe empujando el electrodo a través del tubo hasta que salga de la herramienta.
  - Coloque el pulgar contra el bisel de la punta de la aguja y tire del electrodo restante a través del tubo de la herramienta. Asegúrese de que la punta azul esté completamente dentro del bisel de la aguja.
  - Verifique que sólo la punta estimulante del electrodo esté saliendo de la punta de la punta de la aguja de la herramienta de administración de electrodos.
  - Desbloquee la posición de la aguja empujando el botón deslizante.

- Para uso en un solo paciente, ÚNICAMENTE. NO la vuelva a esterilizar.

Eliminación de la herramienta de administración de electrodos

- Eliminación de material de embalaje – eliminación de residuos sólidos según las políticas hospitalarias
- Todas las piezas con contaminación potencialmente biopeligrosa – Deseche en un recipiente para objetos punzantes de riesgo biológico de tamaño adecuado.
- Por favor, ajústese a las políticas del hospital para el método adecuado de eliminación.


300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tel: 1-888-767-3770 ext. 137
1-440-774-2488 ext. 137
Fax: 1-440-774-2572

Synapse Biomedical - Europa
7 Rue de la Liberation
95880 Enghien Les Bains, Francia
Francia +33 (0) 9 60 12 44 98
Otros países europeos
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797
REF 77-0086-1-ES
Rev. C

La herramienta desechable de administración de electrodos de 10 mm se empaqueta en una bandeja estéril con cubierta Tyvek.

- Retire la bandeja de la caja **ANTES** de usarla en un entorno estéril.
- Tire hacia atrás de la cubierta de Tyvek para retirar la herramienta estéril.
- Localice el botón deslizante de bloqueo de la aguja cerca de la parte superior del lazo del mango para el dedo.

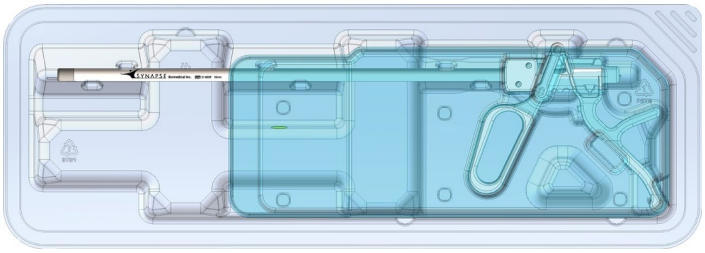

Nota: Humedezca los electrodos con solución salina para ayudar a la inserción a través de la punta de la aguja.



- Opción N.° 1: Carga del electrodo con aguja a 180°:
  - Apriete el mango hasta la segunda posición de bloqueo y bloquee la posición de la aguja empujando el botón deslizante.
  - Disponga el extremo del pasador plateado del electrodo en el área del bisel de la punta de la aguja.
  - Mantenga el electrodo paralelo a la aguja para no dañar la funda de silicona del electrodo mientras se carga a través del tubo de la herramienta.
  - NO dañe el electrodo forzando la entrada del bisel de la aguja.
  - Continúe empujando el electrodo a través de la aguja hasta que su punta se acerque al bisel de la aguja.
  - Coloque el pulgar contra el bisel de la punta de la aguja y tire del electrodo restante a través del tubo de la herramienta. Asegúrese de que la punta azul esté completamente dentro del bisel de la aguja.
  - Verifique que sólo la punta estimulante del electrodo esté saliendo de la punta de la punta de la aguja de la herramienta de administración de electrodos.
  - Sosteniendo el mango, desbloquee la posición de la aguja empujando el botón deslizante.



- Opción N.° 2: Carga del electrodo con aguja a 90°:
  - Apriete el mango hasta la primera posición de bloqueo y bloquee la aguja empujando el botón deslizante.
  - Coloque el extremo del pasador plateado del electrodo en el área del bisel de la punta de la aguja (1)
  - Conserve el electrodo paralelo a la aguja para no dañar la funda de silicona del electrodo.
  - NO dañe el electrodo forzando la entrada del bisel de la aguja.
  - Empuje el electrodo a través de la aguja hasta que la punta del electrodo esté cerca de la punta del bisel.
  - Inserte el extremo del pasador plateado del electrodo en la abertura del tubo del electrodo (2)
  - Continúe empujando el electrodo a través del tubo hasta que salga de la herramienta.
  - Coloque el pulgar contra el bisel de la punta de la aguja y tire del electrodo restante a través del tubo de la herramienta. Asegúrese de que la punta azul esté completamente dentro del bisel de la aguja.
  - Verifique que sólo la punta estimulante del electrodo esté saliendo de la punta de la punta de la aguja de la herramienta de administración de electrodos.
  - Desbloquee la posición de la aguja empujando el botón deslizante.

- Para uso en un solo paciente, ÚNICAMENTE. NO la vuelva a esterilizar.

Eliminación de la herramienta de administración de electrodos

- Eliminación de material de embalaje – eliminación de residuos sólidos según las políticas hospitalarias
- Todas las piezas con contaminación potencialmente biopeligrosa – Deseche en un recipiente para objetos punzantes de riesgo biológico de tamaño adecuado.
- Por favor, ajústese a las políticas del hospital para el método adecuado de eliminación.

300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tel: 1-888-767-3770 ext. 137
1-440-774-2488 ext. 137
Fax: 1-440-774-2572

Synapse Biomedical - Europa
7 Rue de la Liberation
95880 Enghien Les Bains, Francia
Francia +33 (0) 9 60 12 44 98
Otros países europeos
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797
REF 77-0086-1-ES
Rev. C