

L'elettrodo per somministrazione usa e getta da 10 mm è imballato in un vassoio sterile con copertura Tyvek.

- Rimuovere il vassoio dalla scatola **PRIMA** dell'uso in un ambiente sterile.
- Rimuovere la copertura in Tyvek per rimuovere lo strumento sterile.
- Trovare il pulsante scorrevole per il blocco dell'ago accanto alla parte superiore dell'impugnatura circolare per dita.

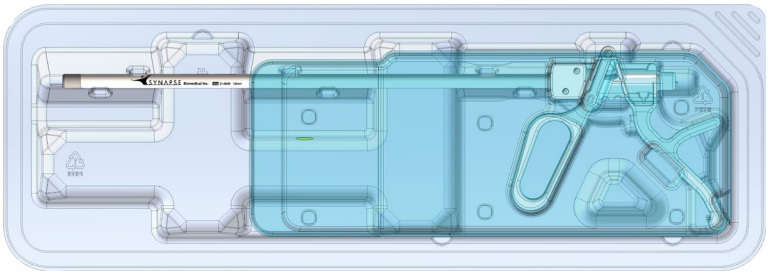

Nota: inumidire gli elettrodi con soluzione salina per facilitare l'inserimento attraverso la punta dell'ago.

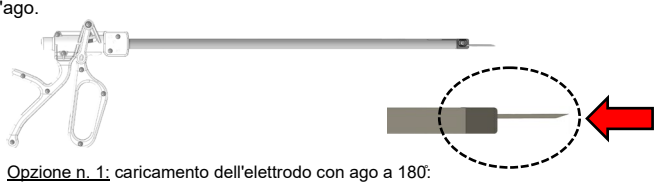

- Opzione n. 1: caricamento dell'elettrodo con ago a 180°:
  - Premere l'impugnatura fino alla seconda posizione di blocco e bloccare l'ago in posizione spingendo il pulsante scorrevole.
  - Poggiare l'estremità del perno d'argento dell'elettrodo nell'area della smussatura della punta dell'ago.
  - Mantenere l'elettrodo parallelo all'ago per non danneggiare la guaina in silicone dell'elettrodo durante il caricamento attraverso il tubo dello strumento.
  - NON danneggiare l'elettrodo forzandolo attraverso la smussatura dell'ago.
  - Continuare a spingere l'elettrodo attraverso l'ago finché la punta dell'elettrodo non si avvicina al taglio dell'ago.
  - Posizionare il pollice contro la smussatura della punta dell'ago e tirare ciò che resta dell'elettrodo attraverso il tubo dello strumento. Assicurare che la punta blu si trovi completamente nella smussatura dell'ago.
  - Verificare che solo la punta di stimolazione dell'elettrodo esca dalla punta dell'ago dell'elettrodo per somministrazione.
  - Mantenendo l'impugnatura, sbloccare la posizione dell'ago premendo il pulsante scorrevole.



- Opzione n. 2: caricamento dell'elettrodo con ago a 90°:
  - Premere l'impugnatura fino alla prima posizione di blocco e bloccare l'ago spingendo il pulsante scorrevole.
  - Poggiare l'estremità del perno d'argento dell'elettrodo nell'area di smussatura della punta dell'ago (1).
  - Mantenere l'elettrodo parallelo all'ago per non danneggiare la guaina in silicone dell'elettrodo.
  - NON danneggiare l'elettrodo forzandolo attraverso la smussatura dell'ago.
  - Spingere l'elettrodo attraverso l'ago finché la punta dell'elettrodo non si avvicina alla punta della smussatura.
  - Inserire il perno di argento dell'elettrodo nell'apertura del tubo dell'elettrodo (2).
  - Continuare a spingere l'elettrodo attraverso il tubo dell'elettrodo finché non esce dallo strumento.
  - Posizionare il pollice contro la smussatura della punta dell'ago e tirare ciò che resta dell'elettrodo attraverso il tubo dello strumento. Assicurare che la punta blu si trovi completamente nella smussatura dell'ago.
  - Verificare che solo la punta di stimolazione dell'elettrodo esca dalla punta dell'ago dell'elettrodo per somministrazione.
  - Sbloccare la posizione dell'ago premendo il pulsante scorrevole.



- SOLO monouso. NON risterilizzare.

Smaltimento dell'elettrodo per somministrazione

- Smaltimento del materiale di imballaggio – smaltimento dei rifiuti solidi secondo le politiche ospedaliere
- Tutte le parti con potenziale contaminazione pericolosa dal punto di vista biologico – Smaltire in un contenitore della dimensione appropriata per materiali taglienti a rischio biologico.
- Rispettare le politiche ospedaliere per il metodo corretto di smaltimento.

300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tel: 1-888-767-3770 int. 137
1-440-774-2488 int. 137
Fax: 1-440-774-2572

SYNAPSE Biomedical Inc.


Synapse Biomedical - Europe
7 Rue de la Liberation
95880 Enghien Les Bains, Francia
Francia +33 (0) 9 60 12 44 98
Altri Paesi europei
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797

RIF. 77-0086-1-IT
Rev. C

L'elettrodo per somministrazione usa e getta da 10 mm è imballato in un vassoio sterile con copertura Tyvek.

- Rimuovere il vassoio dalla scatola **PRIMA** dell'uso in un ambiente sterile.
- Rimuovere la copertura in Tyvek per rimuovere lo strumento sterile.
- Trovare il pulsante scorrevole per il blocco dell'ago accanto alla parte superiore dell'impugnatura circolare per dita.

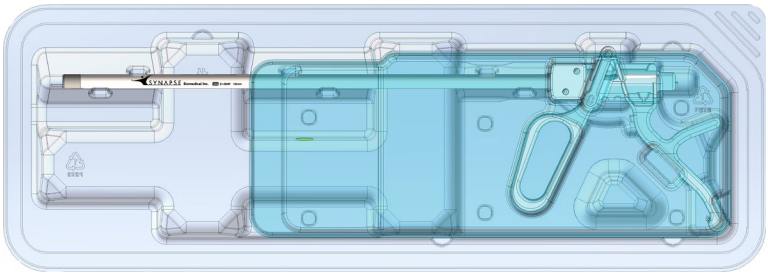

Nota: inumidire gli elettrodi con soluzione salina per facilitare l'inserimento attraverso la punta dell'ago.



- Opzione n. 1: caricamento dell'elettrodo con ago a 180°:
  - Premere l'impugnatura fino alla seconda posizione di blocco e bloccare l'ago in posizione spingendo il pulsante scorrevole.
  - Poggiare l'estremità del perno d'argento dell'elettrodo nell'area della smussatura della punta dell'ago.
  - Mantenere l'elettrodo parallelo all'ago per non danneggiare la guaina in silicone dell'elettrodo durante il caricamento attraverso il tubo dello strumento.
  - NON danneggiare l'elettrodo forzandolo attraverso la smussatura dell'ago.
  - Continuare a spingere l'elettrodo attraverso l'ago finché la punta dell'elettrodo non si avvicina al taglio dell'ago.
  - Posizionare il pollice contro la smussatura della punta dell'ago e tirare ciò che resta dell'elettrodo attraverso il tubo dello strumento. Assicurare che la punta blu si trovi completamente nella smussatura dell'ago.
  - Verificare che solo la punta di stimolazione dell'elettrodo esca dalla punta dell'ago dell'elettrodo per somministrazione.
  - Mantenendo l'impugnatura, sbloccare la posizione dell'ago premendo il pulsante scorrevole.



- Opzione n. 2: caricamento dell'elettrodo con ago a 90°:
  - Premere l'impugnatura fino alla prima posizione di blocco e bloccare l'ago spingendo il pulsante scorrevole.
  - Poggiare l'estremità del perno d'argento dell'elettrodo nell'area di smussatura della punta dell'ago (1).
  - Mantenere l'elettrodo parallelo all'ago per non danneggiare la guaina in silicone dell'elettrodo.
  - NON danneggiare l'elettrodo forzandolo attraverso la smussatura dell'ago.
  - Spingere l'elettrodo attraverso l'ago finché la punta dell'elettrodo non si avvicina alla punta della smussatura.
  - Inserire il perno di argento dell'elettrodo nell'apertura del tubo dell'elettrodo (2).
  - Continuare a spingere l'elettrodo attraverso il tubo dell'elettrodo finché non esce dallo strumento.
  - Posizionare il pollice contro la smussatura della punta dell'ago e tirare ciò che resta dell'elettrodo attraverso il tubo dello strumento. Assicurare che la punta blu si trovi completamente nella smussatura dell'ago.
  - Verificare che solo la punta di stimolazione dell'elettrodo esca dalla punta dell'ago dell'elettrodo per somministrazione.
  - Sbloccare la posizione dell'ago premendo il pulsante scorrevole.



- SOLO monouso. NON risterilizzare.

Smaltimento dell'elettrodo per somministrazione

- Smaltimento del materiale di imballaggio – smaltimento dei rifiuti solidi secondo le politiche ospedaliere
- Tutte le parti con potenziale contaminazione pericolosa dal punto di vista biologico – Smaltire in un contenitore della dimensione appropriata per materiali taglienti a rischio biologico.
- Rispettare le politiche ospedaliere per il metodo corretto di smaltimento.

300 Artino Street
Oberlin, Ohio 44074 U.S.A.
www.synapsebiomedical.com
Tel: 1-888-767-3770 int. 137
1-440-774-2488 int. 137
Fax: 1-440-774-2572

SYNAPSE Biomedical Inc.

Synapse Biomedical - Europe
7 Rue de la Liberation
95880 Enghien Les Bains, Francia
Francia +33 (0) 9 60 12 44 98
Altri Paesi europei
+33 (0) 1 64 95 23 99

CE 2797

RIF. 77-0086-1-IT
Rev. C